

What are FITLEGS[®] AES and FITLEGS[®] AES DVT?
 FITLEGS[®] AES are designed to be worn during and after your hospital stay to help reduce the risk of Deep Vein Thrombosis (DVT). They are blood socks, which can form in the veins. Your healthcare professional (HCP) should tell you if you are at risk of DVT, and should offer you advice on how to reduce your risk.
 FITLEGS[®] AES use elevated medical compression (80 mmHg at ankle), as a preventative measure to reduce the risk of blood clot formation by promoting the blood flow in your legs. These stockings should be worn as recommended by your HCP whilst your mobility is reduced. This document also includes a video demonstrating the correct application of the stockings can be found at www.gsk.com.

FITLEGS[®] AES are intended for use with reduced mobility over the age of 16 by patients:

- 1) Help prevent DVT
- 2) Help prevent the possibility of blood clots by assisting compressed pressure to the leg.
- 3) For any other use, please consult your HCP.

FITLEGS[®] AES may not be suitable for use if you suffer from any of the following:

- 1) Severe peripheral vascular disease
- 2) Severe dermatitis
- 3) Gross untreated oedema of the leg
- 4) Delirium of the leg
- 5) Hypertensive neuropathy
- 6) Sensible leg graft
- 7) Use of AAS with casters or Heberden's joints

*Please refer to your organisation's policy on the prevention of DVT and the use of anti-thrombotic stockings.

Caution:

- Ensure that the stockings are always worn as directed on the packaging
- Do not fold or roll down
- Check daily for accurate fitting
- Stockings should be worn for no longer than 30 minutes daily
- Apply carefully, making sure the suspension hooks under the toes.
- Finger nails, calli or sharp jewellery may damage fabric, and reduce its life. Do not use if fabric shows signs of deterioration.
- If the garment is at the end of two of the following categories, supply a larger size.
- Apply the leg size
- FITLEGS[®] AES are intended for single patient use only.

The following information and side effect details have been identified. Please consult your HCP if concerned.

- Skin damage/abrasion
- Irritation of the skin
- Incontinent urine/urine leakage resulting in skin irritation and an increased risk of skin infection

How do I select the correct size?
 The following information will help you select the correct size. Please consult your HCP if concerned. This measurement should be done at the end of the day, when the feet are most swollen. The measurement should be taken at the widest part of the foot. The measurement should be taken at the widest part of the foot. The measurement should be taken at the widest part of the foot. The measurement should be taken at the widest part of the foot.

Les BAT FITLEGS[®] (des bas thrombotiques) FITLEGS[®] (nommes des antitrombotiques), c'est ce que c'est ?
 Les BAT FITLEGS[®] sont conçus pour être portés pendant et après votre séjour à l'hôpital. Ils sont des bas de compression médicale (80 mmHg au niveau de la cheville), qui aident à réduire le risque de thrombose veineuse profonde (TVP). Cette TVP est le risque de caillots sanguins qui se forment dans les veines. Votre professionnel de santé vous expliquera comment les utiliser et vous indiquera comment les porter. Ces bas doivent être portés selon les recommandations de votre professionnel de santé quant votre mobilité est réduite. Ce document électronique ou mode d'emploi et une vidéo expliquant comment entretenir correctement vos bas sont disponibles sur www.gsk.com.

FITLEGS[®] AES sont destinés à être utilisés par les patients à mobilité réduite, les BAT FITLEGS[®] AES sont destinés à être utilisés par les patients :

- 1) Éviter tout problème de TVP.
- 2) Éviter l'accumulation de sang dans les membres inférieurs en exerçant une pression contrôlée sur les jambes.
- 3) Pour toute autre utilisation, veuillez consulter votre professionnel de santé.

Les BAT FITLEGS[®] ne doivent pas être utilisés si vous souffrez de :

- 1) Maladie vasculaire périphérique sévère
- 2) Dermite grave
- 3) Délirium des jambes
- 4) Incontinence urinaire
- 5) Chiffre de tension artérielle
- 6) Chiffre de tension artérielle

*Veuillez vous référer à la politique de votre organisation en matière de prévention de la thrombose veineuse profonde et d'utilisation des bas antitrombotiques.

Mise en garde :

- Vérifier que les bas sont toujours portés comme indiqué sur l'emballage.
- Ne pas plier ou rouler les bas.
- Vérifier que les crochets de suspension sont bien enfoncés sous les orteils.
- Les ongles, les callosités ou les bijoux peuvent endommager le tissu et réduire sa durée de vie.
- Si le vêtement est dans l'une des deux catégories suivantes, fournir une taille plus grande.
- Appliquer les bas correctement.
- Les BAT FITLEGS[®] AES sont destinés à une utilisation individuelle.

Comment sélectionner la bonne taille ?
 Les informations ci-dessous vous aideront à sélectionner la bonne taille. Veuillez consulter votre HCP si vous avez des questions. Cette mesure doit être prise à la fin de la journée, lorsque les pieds sont les plus gonflés. La mesure doit être prise au plus large de la cheville. La mesure doit être prise au plus large de la cheville. La mesure doit être prise au plus large de la cheville. La mesure doit être prise au plus large de la cheville.

Q: What are FITLEGS[®] AES and FITLEGS[®] AES DVT?
 A: FITLEGS[®] AES are designed to be worn during and after your hospital stay to help reduce the risk of Deep Vein Thrombosis (DVT). They are blood socks, which can form in the veins. Your healthcare professional (HCP) should tell you if you are at risk of DVT, and should offer you advice on how to reduce your risk. FITLEGS[®] AES use elevated medical compression (80 mmHg at ankle), as a preventative measure to reduce the risk of blood clot formation by promoting the blood flow in your legs. These stockings should be worn as recommended by your HCP whilst your mobility is reduced. This document also includes a video demonstrating the correct application of the stockings can be found at www.gsk.com.

FITLEGS[®] AES are intended for use with reduced mobility over the age of 16 by patients:

- 1) Help prevent DVT
- 2) Help prevent the possibility of blood clots by assisting compressed pressure to the leg.
- 3) For any other use, please consult your HCP.

FITLEGS[®] AES may not be suitable for use if you suffer from any of the following:

- 1) Severe peripheral vascular disease
- 2) Severe dermatitis
- 3) Gross untreated oedema of the leg
- 4) Delirium of the leg
- 5) Hypertensive neuropathy
- 6) Sensible leg graft
- 7) Use of AAS with casters or Heberden's joints

*Please refer to your organisation's policy on the prevention of DVT and the use of anti-thrombotic stockings.

Caution:

- Ensure that the stockings are always worn as directed on the packaging
- Do not fold or roll down
- Check daily for accurate fitting
- Stockings should be worn for no longer than 30 minutes daily
- Apply carefully, making sure the suspension hooks under the toes.
- Finger nails, calli or sharp jewellery may damage fabric, and reduce its life. Do not use if fabric shows signs of deterioration.
- If the garment is at the end of two of the following categories, supply a larger size.
- Apply the leg size
- FITLEGS[®] AES are intended for single patient use only.

The following information and side effect details have been identified. Please consult your HCP if concerned.

- Skin damage/abrasion
- Irritation of the skin
- Incontinent urine/urine leakage resulting in skin irritation and an increased risk of skin infection

How do I select the correct size?
 The following information will help you select the correct size. Please consult your HCP if concerned. This measurement should be done at the end of the day, when the feet are most swollen. The measurement should be taken at the widest part of the foot. The measurement should be taken at the widest part of the foot. The measurement should be taken at the widest part of the foot. The measurement should be taken at the widest part of the foot.

CS Licensors Europe Limited
 The Blak, Church, St Mary's Place,
 Dublin 1, D07 M2K2, Ireland
 Email: emp@cslicensors.com


CS Licensors Europe Limited
 The Blak, Church, St Mary's Place,
 Dublin 1, D07 M2K2, Ireland
 Email: emp@cslicensors.com

CS Licensors Europe Limited
 The Blak, Church, St Mary's Place,
 Dublin 1, D07 M2K2, Ireland
 Email: emp@cslicensors.com

CS Licensors Europe Limited
 The Blak, Church, St Mary's Place,
 Dublin 1, D07 M2K2, Ireland
 Email: emp@cslicensors.com

CS Licensors Europe Limited
 The Blak, Church, St Mary's Place,
 Dublin 1, D07 M2K2, Ireland
 Email: emp@cslicensors.com

CS Licensors Europe Limited
 The Blak, Church, St Mary's Place,
 Dublin 1, D07 M2K2, Ireland
 Email: emp@cslicensors.com



CS Licensors Europe Limited
 The Blak, Church, St Mary's Place,
 Dublin 1, D07 M2K2, Ireland
 Email: emp@cslicensors.com

CS Licensors Europe Limited
 The Blak, Church, St Mary's Place,
 Dublin 1, D07 M2K2, Ireland
 Email: emp@cslicensors.com


CS Licensors Europe Limited
 The Blak, Church, St Mary's Place,
 Dublin 1, D07 M2K2, Ireland
 Email: emp@cslicensors.com

CS Licensors Europe Limited
 The Blak, Church, St Mary's Place,
 Dublin 1, D07 M2K2, Ireland
 Email: emp@cslicensors.com

CS Licensors Europe Limited
 The Blak, Church, St Mary's Place,
 Dublin 1, D07 M2K2, Ireland
 Email: emp@cslicensors.com

CS Licensors Europe Limited
 The Blak, Church, St Mary's Place,
 Dublin 1, D07 M2K2, Ireland
 Email: emp@cslicensors.com

Anti-Embolism Stockings (AES)
Bas anti-thrombose (BAT)
Medias antiembolia (AES)
Calze antitrombo (AES)
Anti-Embolie-Strümpfe (AES)
Meias antiembolia (MA)
Po czochy przeciwzatorowe (AES)

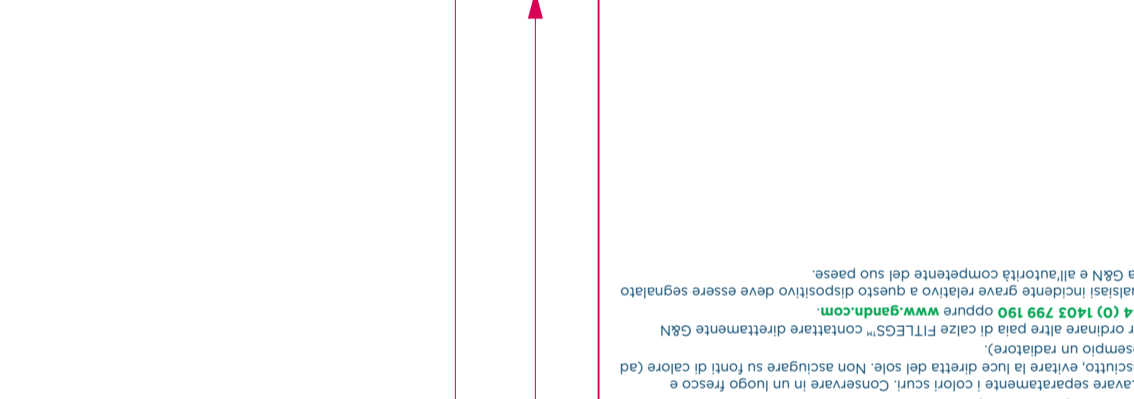

FITLEGS[®] AES is a medical device, which may be suitable for use for patients from any of the following:
 Severe peripheral vascular disease/gross oedema/untreated oedema of the leg
 Delirium of the leg
 Hypertensive neuropathy
 Sensible leg graft
 Use of AAS with casters or Heberden's joints

Les BAT FITLEGS[®] (des bas thrombotiques) FITLEGS[®] (nommes des antitrombotiques), c'est ce que c'est ?
 Les BAT FITLEGS[®] sont conçus pour être portés pendant et après votre séjour à l'hôpital. Ils sont des bas de compression médicale (80 mmHg au niveau de la cheville), qui aident à réduire le risque de thrombose veineuse profonde (TVP). Cette TVP est le risque de caillots sanguins qui se forment dans les veines. Votre professionnel de santé vous expliquera comment les utiliser et vous indiquera comment les porter. Ces bas doivent être portés selon les recommandations de votre professionnel de santé quant votre mobilité est réduite. Ce document électronique ou mode d'emploi et une vidéo expliquant comment entretenir correctement vos bas sont disponibles sur www.gsk.com.

FITLEGS[®] AES sont destinés à être utilisés par les patients à mobilité réduite, les BAT FITLEGS[®] AES sont destinés à être utilisés par les patients :

- 1) Éviter tout problème de TVP.
- 2) Éviter l'accumulation de sang dans les membres inférieurs en exerçant une pression contrôlée sur les jambes.
- 3) Pour toute autre utilisation, veuillez consulter votre professionnel de santé.

Les BAT FITLEGS[®] ne doivent pas être utilisés si vous souffrez de :

- 1) Maladie vasculaire périphérique sévère
- 2) Dermite grave
- 3) Délirium des jambes
- 4) Incontinence urinaire
- 5) Chiffre de tension artérielle
- 6) Chiffre de tension artérielle

*Veuillez vous référer à la politique de votre organisation en matière de prévention de la thrombose veineuse profonde et d'utilisation des bas antitrombotiques.

Mise en garde :

- Vérifier que les bas sont toujours portés comme indiqué sur l'emballage.
- Ne pas plier ou rouler les bas.
- Vérifier que les crochets de suspension sont bien enfoncés sous les orteils.
- Les ongles, les callosités ou les bijoux peuvent endommager le tissu et réduire sa durée de vie.
- Si le vêtement est dans l'une des deux catégories suivantes, fournir une taille plus grande.
- Appliquer les bas correctement.
- Les BAT FITLEGS[®] AES sont destinés à une utilisation individuelle.

Comment sélectionner la bonne taille ?
 Les informations ci-dessous vous aideront à sélectionner la bonne taille. Veuillez consulter votre HCP si vous avez des questions. Cette mesure doit être prise à la fin de la journée, lorsque les pieds sont les plus gonflés. La mesure doit être prise au plus large de la cheville. La mesure doit être prise au plus large de la cheville. La mesure doit être prise au plus large de la cheville. La mesure doit être prise au plus large de la cheville.

FITLEGS[®] AES is a medical device, which may be suitable for use for patients from any of the following:
 Severe peripheral vascular disease/gross oedema/untreated oedema of the leg
 Delirium of the leg
 Hypertensive neuropathy
 Sensible leg graft
 Use of AAS with casters or Heberden's joints

Les BAT FITLEGS[®] (des bas thrombotiques) FITLEGS[®] (nommes des antitrombotiques), c'est ce que c'est ?
 Les BAT FITLEGS[®] sont conçus pour être portés pendant et après votre séjour à l'hôpital. Ils sont des bas de compression médicale (80 mmHg au niveau de la cheville), qui aident à réduire le risque de thrombose veineuse profonde (TVP). Cette TVP est le risque de caillots sanguins qui se forment dans les veines. Votre professionnel de santé vous expliquera comment les utiliser et vous indiquera comment les porter. Ces bas doivent être portés selon les recommandations de votre professionnel de santé quant votre mobilité est réduite. Ce document électronique ou mode d'emploi et une vidéo expliquant comment entretenir correctement vos bas sont disponibles sur www.gsk.com.

FITLEGS[®] AES sont destinés à être utilisés par les patients à mobilité réduite, les BAT FITLEGS[®] AES sont destinés à être utilisés par les patients :

- 1) Éviter tout problème de TVP.
- 2) Éviter l'accumulation de sang dans les membres inférieurs en exerçant une pression contrôlée sur les jambes.
- 3) Pour toute autre utilisation, veuillez consulter votre professionnel de santé.

Les BAT FITLEGS[®] ne doivent pas être utilisés si vous souffrez de :

- 1) Maladie vasculaire périphérique sévère
- 2) Dermite grave
- 3) Délirium des jambes
- 4) Incontinence urinaire
- 5) Chiffre de tension artérielle
- 6) Chiffre de tension artérielle

*Veuillez vous référer à la politique de votre organisation en matière de prévention de la thrombose veineuse profonde et d'utilisation des bas antitrombotiques.

Mise en garde :

- Vérifier que les bas sont toujours portés comme indiqué sur l'emballage.
- Ne pas plier ou rouler les bas.
- Vérifier que les crochets de suspension sont bien enfoncés sous les orteils.
- Les ongles, les callosités ou les bijoux peuvent endommager le tissu et réduire sa durée de vie.
- Si le vêtement est dans l'une des deux catégories suivantes, fournir une taille plus grande.
- Appliquer les bas correctement.
- Les BAT FITLEGS[®] AES sont destinés à une utilisation individuelle.

Comment sélectionner la bonne taille ?
 Les informations ci-dessous vous aideront à sélectionner la bonne taille. Veuillez consulter votre HCP si vous avez des questions. Cette mesure doit être prise à la fin de la journée, lorsque les pieds sont les plus gonflés. La mesure doit être prise au plus large de la cheville. La mesure doit être prise au plus large de la cheville. La mesure doit être prise au plus large de la cheville. La mesure doit être prise au plus large de la cheville.

FITLEGS[®] AES is a medical device, which may be suitable for use for patients from any of the following:
 Severe peripheral vascular disease/gross oedema/untreated oedema of the leg
 Delirium of the leg
 Hypertensive neuropathy
 Sensible leg graft
 Use of AAS with casters or Heberden's joints

Les BAT FITLEGS[®] (des bas thrombotiques) FITLEGS[®] (nommes des antitrombotiques), c'est ce que c'est ?
 Les BAT FITLEGS[®] sont conçus pour être portés pendant et après votre séjour à l'hôpital. Ils sont des bas de compression médicale (80 mmHg au niveau de la cheville), qui aident à réduire le risque de thrombose veineuse profonde (TVP). Cette TVP est le risque de caillots sanguins qui se forment dans les veines. Votre professionnel de santé vous expliquera comment les utiliser et vous indiquera comment les porter. Ces bas doivent être portés selon les recommandations de votre professionnel de santé quant votre mobilité est réduite. Ce document électronique ou mode d'emploi et une vidéo expliquant comment entretenir correctement vos bas sont disponibles sur www.gsk.com.

FITLEGS[®] AES sont destinés à être utilisés par les patients à mobilité réduite, les BAT FITLEGS[®] AES sont destinés à être utilisés par les patients :

- 1) Éviter tout problème de TVP.
- 2) Éviter l'accumulation de sang dans les membres inférieurs en exerçant une pression contrôlée sur les jambes.
- 3) Pour toute autre utilisation, veuillez consulter votre professionnel de santé.

Les BAT FITLEGS[®] ne doivent pas être utilisés si vous souffrez de :

- 1) Maladie vasculaire périphérique sévère
- 2) Dermite grave
- 3) Délirium des jambes
- 4) Incontinence urinaire
- 5) Chiffre de tension artérielle
- 6) Chiffre de tension artérielle

*Veuillez vous référer à la politique de votre organisation en matière de prévention de la thrombose veineuse profonde et d'utilisation des bas antitrombotiques.

Mise en garde :

- Vérifier que les bas sont toujours portés comme indiqué sur l'emballage.
- Ne pas plier ou rouler les bas.
- Vérifier que les crochets de suspension sont bien enfoncés sous les orteils.
- Les ongles, les callosités ou les bijoux peuvent endommager le tissu et réduire sa durée de vie.
- Si le vêtement est dans l'une des deux catégories suivantes, fournir une taille plus grande.
- Appliquer les bas correctement.
- Les BAT FITLEGS[®] AES sont destinés à une utilisation individuelle.

Comment sélectionner la bonne taille ?
 Les informations ci-dessous vous aideront à sélectionner la bonne taille. Veuillez consulter votre HCP si vous avez des questions. Cette mesure doit être prise à la fin de la journée, lorsque les pieds sont les plus gonflés. La mesure doit être prise au plus large de la cheville. La mesure doit être prise au plus large de la cheville. La mesure doit être prise au plus large de la cheville. La mesure doit être prise au plus large de la cheville.

CS Licensors Europe Limited
 The Blak, Church, St Mary's Place,
 Dublin 1, D07 M2K2, Ireland
 Email: emp@cslicensors.com


CS Licensors Europe Limited
 The Blak, Church, St Mary's Place,
 Dublin 1, D07 M2K2, Ireland
 Email: emp@cslicensors.com

CS Licensors Europe Limited
 The Blak, Church, St Mary's Place,
 Dublin 1, D07 M2K2, Ireland
 Email: emp@cslicensors.com

CS Licensors Europe Limited
 The Blak, Church, St Mary's Place,
 Dublin 1, D07 M2K2, Ireland
 Email: emp@cslicensors.com

CS Licensors Europe Limited
 The Blak, Church, St Mary's Place,
 Dublin 1, D07 M2K2, Ireland
 Email: emp@cslicensors.com

CS Licensors Europe Limited
 The Blak, Church, St Mary's Place,
 Dublin 1, D07 M2K2, Ireland
 Email: emp@cslicensors.com

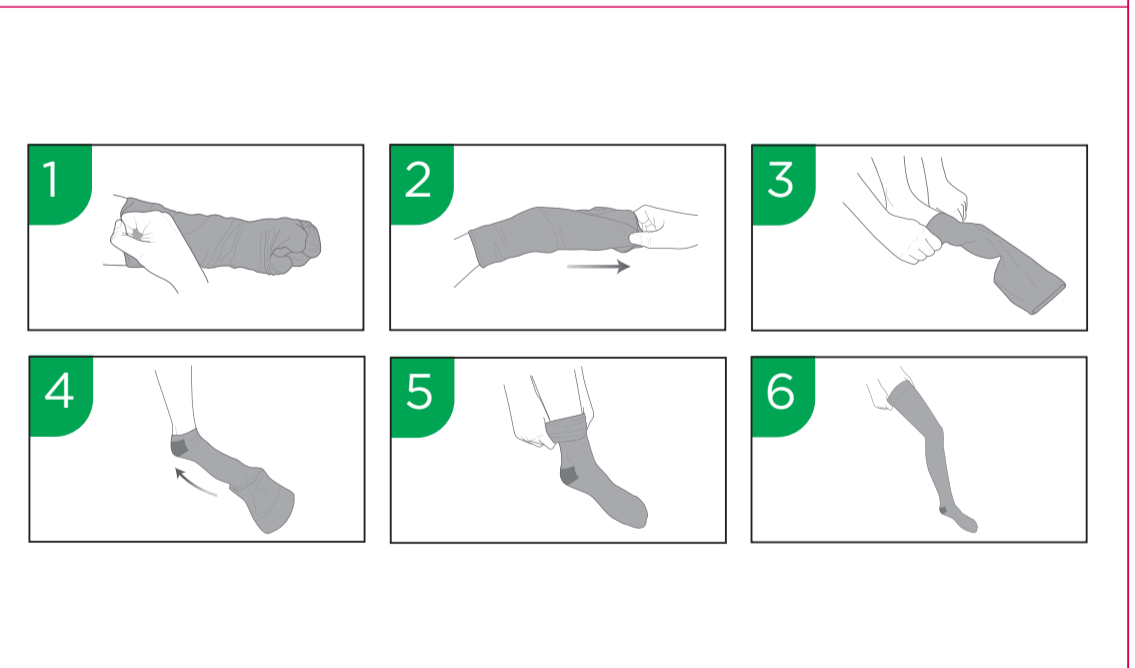

Front

Back

